

3 года  
гарантии\*



**ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ПРИБОРЫ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  
ОТРАСЛИ**

Актуальными задачами современного фармацевтического производства являются:


- контроль безопасности и качества:
  - синтетических субстанций и природного лекарственного сырья,
  - активных фармацевтических ингредиентов,
  - вспомогательных веществ,
  - готовых лекарственных средств;
- внутрипроизводственный и межоперационный контроль технологических процессов;
- разработка новых препаратов и отработка методов их анализа;
- изучение фармакокинетики;
- оценка качества воды, используемой в технологических процессах;
- установление фактов фальсификации.

Для решения этих задач необходимы современные, надежные и экономичные методы анализа, среди которых все большее распространение получают инструментальные методы. Об этом свидетельствует появление большого числа общих фармакопейных статей на такие методы в **Государственной Фармакопее Российской Федерации (XII издание)**.

Группа компаний «ЛЮМЭКС» уже не одно десятилетие производит современные приборы, удовлетворяющие требованиям ГФ XII по инструментальным методам анализа:

- инфракрасная спектроскопия – **инфракрасный фурье-спектрометр «ИнфралЮМ® ФТ-08»** с широким набором приставок и специализированных библиотек спектров;
- капиллярный электрофорез – **системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ»**;
- высокоэффективная жидкостная хроматография – **жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®»** с набором детекторов (спектрофотометрическим, флуориметрическим и спектрофлуориметрическим);
- флуориметрия и фотометрия – **спектрофлуориметр «ФЛЮОРAT®-02-ПАНОРАМА»** и **флуориметр серии «ФЛЮОРAT®-02»**;
- атомно-абсорбционная спектроскопия – **атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-915МД»** и **анализатор ртути «РА-915М»**.
- спектроскопия в ближней инфракрасной области – **БИК-анализатор «ИнфралЮМ® ФТ-10»**.

Приборы «ЛЮМЭКС» применяются также для анализа растительного сырья и биологически-активных добавок согласно Р 4.1.1672-03.

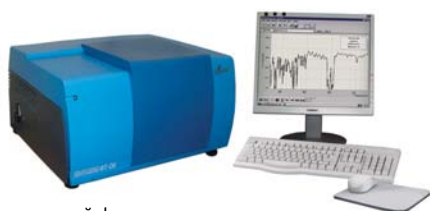

Инфракрасный фурье-спектрометр «ИнфралЮМ® ФТ-08»



Система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ»



Флуориметр серии «ФЛЮОРAT®-02»



Жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®»



Спектрофлуориметр «ФЛЮОРAT®-02-ПАНОРАМА»



Анализатор ртути «РА-915М»



Атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-915МД»



БИК-анализатор «ИнфралЮМ® ФТ-10»

**МЕТОД ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ (ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ)** является стандартным методом в фармацевтической отрасли. Он прописан во многих фармацевтических статьях Российской и зарубежных фармакопей и уже давно с успехом применяется в повседневной лабораторной практике.

#### ОСНОВНЫЕ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- Определение подлинности и чистоты субстанций и вспомогательных веществ.
- Оперативный технологический контроль.
- Идентификация лекарственных средств.
- Выявление фальсификатов.

Одним из современных видов ИК-спектрометров являются **ИК-спектрометры с преобразованием Фурье**. С их помощью специалисты могут **регистрировать спектры** лекарственных препаратов **с максимальной точностью**, а значит **с наибольшей точностью и достоверностью получать результаты**.

Группой компаний «ЛЮМЭКС» серийно выпускается **ИК-фурье-спектрометр «ИнфраЛЮМ® ФТ-08»** с широким набором приставок, включая приставку НПВО и приставку диффузного отражения.

Анализы фармпрепаратов с использованием ИК-фурье-спектрометра «ИнфраЛЮМ® ФТ-08» производятся как с применением **стандартных методик** (прессование с KBr или растирание с вазелиновым маслом), так и с использованием **экспрессных методов НПВО** (нарушенного полного внутреннего отражения) и **диффузного отражения**.

#### ДОСТОИНСТВА ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРА

##### «ИНФРАЛЮМ® ФТ-08»:

- Высокое отношение сигнал / шум.
- Высокая точность и достоверность получаемых результатов.
- Отсутствие необходимости проведения периодической градуировки.
- Широкий набор кювет и приставок собственного производства и приставок компании «Pike Technologies».
- Собственное современное программное обеспечение «СпектраЛЮМ®».
- Возможность использования общих и тематических библиотек спектров.

#### ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

##### «СПЕКТРАЛЮМ®»:

- Реализация всех основных операций со спектрами.
- Соответствие требованиям 21 CFR Part 11 и GLP.
- Подключение тематических библиотек спектров форматов JCamp.
- Создание собственных библиотек как на основе спектров, снятых на ИК-фурье-спектрометрах серии «ИнфраЛЮМ®», так и на основе спектров форматов src, jcr, jdx и др.
- 24-разрядное АЦП, интерфейс USB 2.0, 32-разрядная ОС «Windows® 2000/XP/7».

#### БИБЛИОТЕКИ ИК-СПЕКТРОВ ВЕЩЕСТВ

Для проведения качественного анализа и идентификации соединений ГК «ЛЮМЭКС» предлагает два типа спектральных библиотек:


- на базе спектров пропускания (через прессованную таблетку из анализируемого образца с KBr или через слой жидкой пробы);
- на базе спектров нарушенного полного внутреннего отражения (с использованием приставок НПВО).

Все библиотечные спектры были зарегистрированы с использованием ИК-фурье-спектрометров.

В сотрудничестве с японской компанией «S.T. Japan-Europe» специально для ПО «СпектраЛЮМ®» разработаны общие и тематические библиотеки спектров **формата JCamp**.

ИК-фурье-спектрометры серии «ИнфраЛЮМ®» опробованы и успешно используются на ряде отечественных фармацевтических предприятий, в научных организациях и в вузах отрасли.


Материалы, полученные с использованием спектрометров серии «ИнфраЛЮМ®», использованы в практическом руководстве **«Экспресс-анализ с целью выявления фальсифицированных лекарственных средств»** (А.П. Арзамасцев, В.Л. Дорофеев и др.).

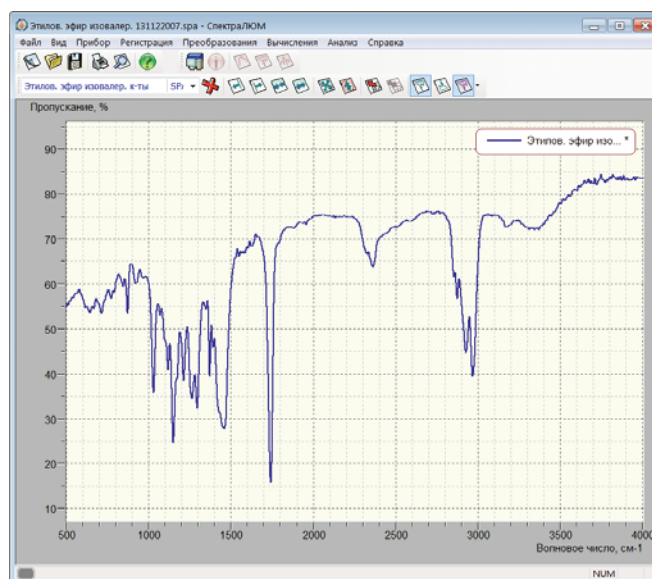

ИК-спектр эфира изовалериановой кислоты.

**МЕТОД БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ (БИК) СПЕКТРОМЕТРИИ** для фармацевтики является достаточно новым и перспективным и в последние годы в России и за рубежом переживает существенный рост. Метод включен в ряд зарубежных фармакопей, а также в ГФ РФ XII.

Метод БИК-анализа находит применение как в технологическом контроле, так и при контроле готовых лекарственных средств.

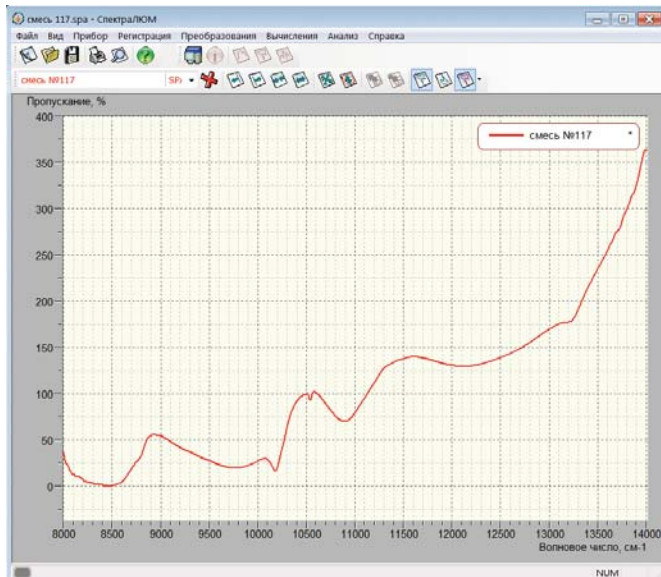


БИК-спектр фармацевтической смеси.

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА:

- малое время анализа – 1–2 минуты;
- неразрушающий анализ фармпрепаратов без пробоподготовки;
- возможность одновременного определения нескольких компонентов или параметров.

Группой компаний «Люмэкс» предлагаются **фурье-анализаторы в ближней ИК-области серии «ИнфралЮМ ФТ®»**. С их помощью можно измерять спектры субстанций и лекарственных средств в ближней инфракрасной области спектра и с помощью специализированного ПО «СпектралЮМ/Про®» проводить качественный и количественный анализ.

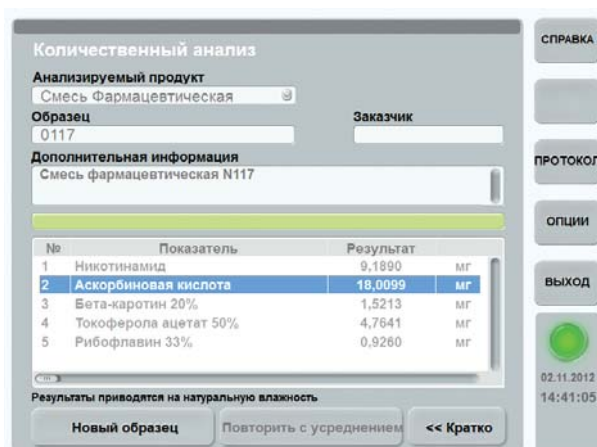

Результаты анализа фармацевтической смеси.

**МЕТОД БЕСПЛАМЕННОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ (ААС)** является общепринятым методом для количественного определения **тяжелых металлов** и других **токсичных элементов** в фармацевтических субстанциях и лекарственном растительном сырье (Ph. Eur. 2.4.27). В ГФ РФ XII, например, этот метод предписан для измерения содержания **алюминия** (ОФС 42-0101-09) и **ртути** (ОФС 42-0105-09).

ГК «ЛЮМЭКС» выпускает два вида приборов, реализующих метод ААС. В каждом из них используется **зеemanовская коррекция неселективного поглощения**, облегчающая работу с пробами сложного состава.

**Атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-915МД»** предназначен для определения химических элементов в жидких пробах, а также в твердых образцах после их минерализации.

#### ДОСТОИНСТВА СПЕКТРОМЕТРА «МГА-915МД»:

- В приборах реализован современный вариант ААС – **ААС с электротермической атомизацией**.
- Использование **высокочастотных источников излучения**, имеющих высокую интенсивность аналитических линий.
- **Низкие пределы обнаружения** (см. табл.).
- **Отсутствие необходимости использования горючих газов** повышает безопасность работы и существенно упрощает процедуру ввода прибора в эксплуатацию.
- Использование **автосемплера с 55 ячейками** для проб.
- Полный **компьютерный контроль** спектрометра.

Узкоспециализированный **анализатор ртути «РА-915М» с широким набором приставок** предназначен для измерения содержания ртути в жидких, твердых и газообразных пробах.

#### ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРА РТУТИ «РА-915М»:

- Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает **ультранизкий предел обнаружения ртути при прямом анализе** (см. табл.).
- Благодаря использованию стандартной одноходовой и уникальной многоходовой кювет достигается **широкий динамический диапазон измерений**.
- Для большинства жидких и твердых проб **время одного измерения не превышает 2-х минут**.

#### Пределы определения (ПО) некоторых элементов (критерий 3σ)

Элемент	Длина волны, нм	Абсолютный ПО, пг	Относительный ПО, мкг/л
Al	309,3	1,5	0,038
As	194,0	4	0,0008*
Cd	228,8	0,01	0,00025
Cr	357,9	0,4	0,01
Cu	324,7	1	0,025
Fe	248,3	2	0,05
Hg	253,7	10 (2–5**)	0,002* (0,0005**)
Pb	283,3	2	0,05
Se	196,1	4	0,0008*
Zn	213,9	0,01	0,00025

\* с ртутно-гидридной приставкой «РГП-915».

\*\* для анализаторов «РА-915М».

Для повышения экспрессности единичного определения и в целом производительности, улучшения воспроизводимости результатов анализа проб, имеющих сложную матрицу, ГК «ЛЮМЭКС» разработала и серийно производит **систему микроволновой подготовки проб «МИНОТАВР®-2»**.

**МЕТОД ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ** широко применяется для контроля безопасности и качества синтетических субстанций, природного сырья, активных фармацевтических ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств.

ГК «ЛЮМЭКС» производит **модульный жидкостный хроматограф «ЛЮМАХРОМ®»** со следующими детекторами:

- спектрофотометрическим,
- флуориметрическим,
- спектрофлуориметрическим.

#### ДОСТОИНСТВА ХРОМАТОГРАФА «ЛЮМАХРОМ®»:

- **Универсальность жидкостного хроматографа** заключается в широком выборе методов детектирования, повышении информативности хроматографического анализа при одновременном использовании 2-х детекторов, а также в совместимости с любым другим типом детектора для ВЭЖХ.
- **Блочно-модульный принцип** позволяет создать оптимальную конфигурацию жидкостного хроматографа для решения конкретных задач пользователя.

- **Точная беспульсационная схема подачи элюента** идеально подходит для микроколоночной ВЭЖХ.
- Использование **термостата колонок** позволяет минимизировать воздействие внешних факторов на воспроизводимость результатов измерений.
- **Хроматографические колонки** внутренним диаметром 2,1 мм **собственного производства** минимизируют расходы подвижной фазы, повышают экспрессность анализа, уменьшают себестоимость единичного определения.
- Реализуется **возможность комплектования** жидкостного хроматографа **колонок и предколонок как микро-, так и аналитического масштаба**, производства «ЛЮМЭКС» и/или альтернативного.
- **Независимость** модулей позволяет использовать их в составе ВЭЖХ-систем других производителей.
- **Современные компьютерные программы** предоставляют возможность автоматического сбора и обработки данных с последующим формированием отчета в удобном для пользователя виде.

В современных фармакопеях **ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД** измерений применяется при испытаниях субстанций на предельные содержания **алюминия** (ОФС 42-0101-09, Ph. Eur. 2.4.17) в пробах воды, солей калия, кальция, магния и натрия, а также в образцах лимонной кислоты.

Флуориметрический метод измерений реализован в следующих серийных приборах «ЛЮМЭКС»:

- **анализатор «Флюорат®-02-5М»**
- **анализатор «Флюорат®-02-4М»**
- **анализатор жидкости «Флюорат®-02-3М»**
- **анализатор жидкости «Флюорат®-02-2М»;**
- **спектрофлуориметр «Флюорат®-02-Панорама».**

Анализаторы жидкости серии «ФЛЮОРАТ®-02» предназначены для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах, пищевых продуктах и других объектах после переведения анализируемых веществ в раствор.

Основной режим работы анализаторов – флуориметрический. Приборы могут также с успехом работать как фотометры или хемилюминометры.

По сравнению с базовыми модификациями – «ФЛЮОРАТ®-02-3М/5М», модификации «ФЛЮОРАТ®-02-2М/4М» обладают дополнительными возможностями. В них реализован режим измерения фосфоресценции, а также использование в качестве флуориметрического детектора в составе жидкостного хроматографа «ЛЮМАХРОМ®».

#### ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ «ФЛЮОРАТ®-02»:

- низкие пределы определения;
- малый расход основных и вспомогательных реактивов;
- небольшое время анализа;
- высокая селективность;
- сохранение градуировок в энергонезависимой памяти;
- многофункциональность.

Более широкими возможностями обладает **спектрофлуориметр «Флюорат®-02-Панорама».**

Этот прибор предназначен для:

- измерения спектров люминесценции и оптического пропускания образцов;
- измерения времени затухания фосфоресценции, хеми(био)люминесценции;
- флуоресцентного детектирования при хроматографическом разделении.

#### ДОСТОИНСТВА СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРА «ФЛЮОРАТ®-02-ПАНОРАМА»:

- наличие монохроматоров в каналах возбуждения и регистрации люминесценции;
- использование прибора в качестве спектрофлуориметрического детектора для ВЭЖХ;
- программируемое изменение длин волн во время хроматографического разделения;
- возможность синхронного спектрального сканирования, двумерного сканирования;
- наличие современного, удобного в работе собственного программного обеспечения;
- широкий выбор дополнительных приставок для измерений вне кюветного отделения.

**МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФЕРЕЗА** (КЭ) является сравнительно новым методом, только в последнее время нашедшим применение в рутинной лабораторной практике.

Многочисленные варианты метода КЭ используются для разделения:

- **заряженных частиц и комплексов,**
- **нейтральных молекул,**
- **гидрофобных, гидрофильных компонентов,**
- **позиционных и оптических изомеров,**
- **низкомолекулярных соединений,**
- **белков и олигонуклеотидов.**

С момента своего появления метод КЭ часто сравнивают с методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). У этих методов много общего: разделение происходит в среде жидкой фазы (буфере или подвижной фазе), в ограниченном пространстве (капилляре или колонке) и с использованием одинаковых принципов детектирования.

В то же время метод капиллярного электрофореза обладает рядом **преимуществ**:

- **высочайшая, уникальная эффективность разделения компонентов смесей;**
- **экспрессность;**
- **крайне низкий расход реактивов и растворителей;**
- **отсутствие дорогостоящих колонок с сорбентами и проблем с их старением и заменой;**
- **низкая стоимость прибора и единичного анализа;**
- **простота анализа.**

Как инструментальный метод анализа, метод КЭ вошел во все современные фармакопеи:

- **ГФ РФ XII. ОФС 42-0082-08;**
- **ГФ Республики Беларусь 2.2.47;**
- **Ph. Eur. 2.2.47;**
- **USP General Information Ch. <1053> Biotechnology-derived Articles – Capillary Electrophoresis;**
- **Brit. Ph. Vol. IV, Appendix III G. Capillary electrophoresis;**
- **JP General Information 4. Capillary Electrophoresis;**
- **Ph. Br. 5.2.22.1.**

Кроме того, метод КЭ вошел в следующие статьи Европейской Фармакопеи, где с его помощью решаются следующие аналитические задачи:

- идентификация **рекомбинантного эритропоэтина** (Ph. Eur. 1316),
- анализ примесей в **соматотропине** (Ph. Eur. 0950 и 0952),
- определение примесей в субстанциях **апротинина** (Ph. Eur. 0579 и 0580),
- определение примесей в субстанциях **гепарина** (Ph. Eur. 0332 и 0333; Письмо Росздравнадзора от 08.09.2008 № ОЗИ-578/08),
- определение энантиомерной чистоты **ропивакаина** (Ph. Eur. 2837).

Метод КЭ показал свою эффективность для решения следующих групп аналитических задач:

- **определение ионного состава (включая определение противоионов),**
- **энантиомерный анализ,**
- **определение низкомолекулярных соединений,**
- **анализ биомолекул,**

- **анализ растительного сырья,**
- **физико-химические исследования,**
- **изучение фармакокинетики.**

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОННОГО СОСТАВА

Классической задачей для метода КЭ является определение ионного состава. С помощью системы КЭ «КАПЕЛЬ®-105М» можно *получить полную информацию о концентриациях неорганических и органических анионов* (фторидов, хлоридов, бромидов, иодидов, нитритов, нитратов, фосфатов, сульфатов и ацетатов) и *неорганических катионов* (аммония, калия, натрия, лития, магния, кальция, стронция и бария).

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

*Анальгетики и антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, β-лактамы), барбитураты и трициклические антидепрессанты, пурины и флавоноиды, аминокислоты и витамины – все эти соединения можно определять в готовых фармпрепаратах и сырье для их производства.*

Отсутствие стадии дериватизации, легкость подбора условий разделения для близких по структуре и физико-химическим свойствам соединений делает метод КЭ привлекательным для *анализа основного действующего вещества.*

Метод КЭ незаменим при *анализе микропримесей*, а также при определении *продуктов разложения* фармацевтических субстанций.

#### ЭНАНТИОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ

При определении *энантиомерной чистоты* соединения метод КЭ имеет существенные преимущества перед ближайшим альтернативным методом – методом ВЭЖХ:

- простота подбора добавок (хиральных селекторов),
- легкость оптимизации условий разделения энантиомеров.

#### АНАЛИЗ БИОМОЛЕКУЛ








Для разделения белков с разной молекулярной массой в настоящее время широко используются метод электрофореза в полиакриламидном геле (SDS-PAGE). Важной альтернативой ему является **капиллярный гель-электрофорез (CGE, КГЭ)**. С помощью метода КГЭ можно *разделить белки, отличающиеся по массам на 4 % и более.*

Метод капиллярного **изоэлектрофокусирования (CIEF, КИЭФ)** *применяется для разделения белков с примерно одинаковой молекулярной массой, но с различными изоэлектрическими точками* (разделение изоформ с разным зарядом).

При помощи данного метода могут быть разделены *белки с изоэлектрическими точками, отличающимися всего на 0.04 единицы pI.*

По сравнению с разделением белков классическими методами SDS-PAGE, **капиллярные варианты электрофореза обладают несколькими преимуществами:**

- полная автоматизация разделения;
- прямое количественное определение;
- отсутствие стадии окрашивания.

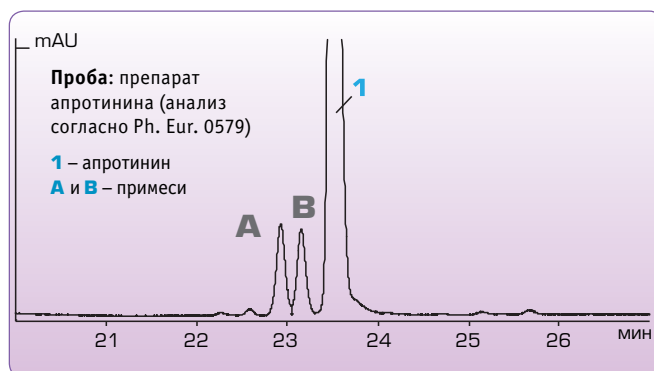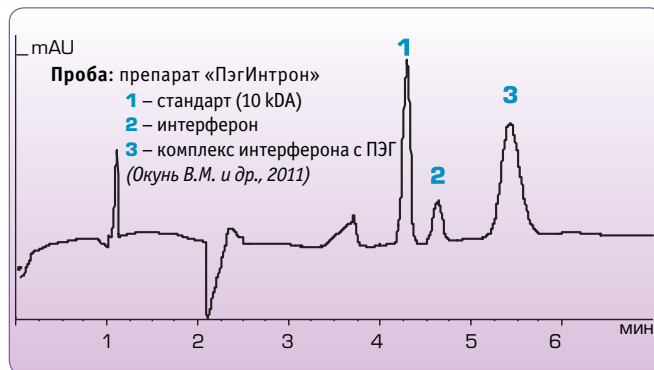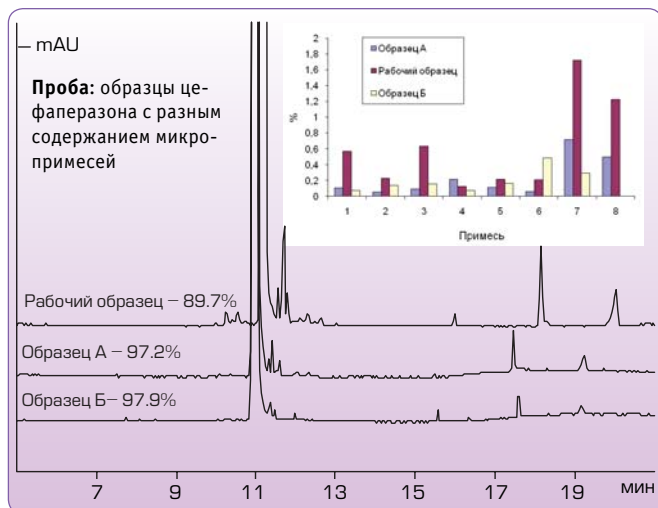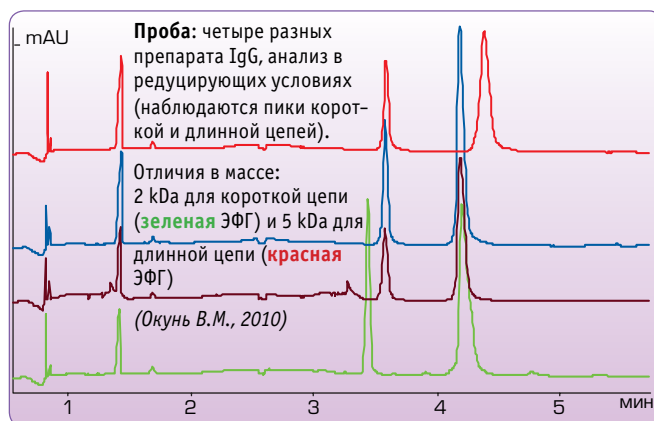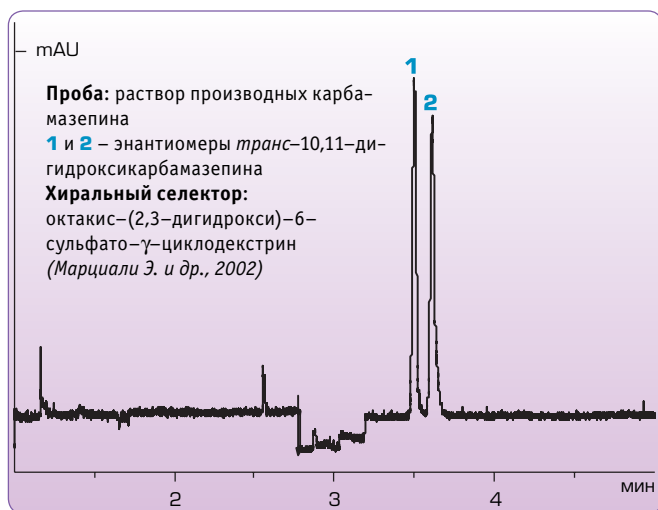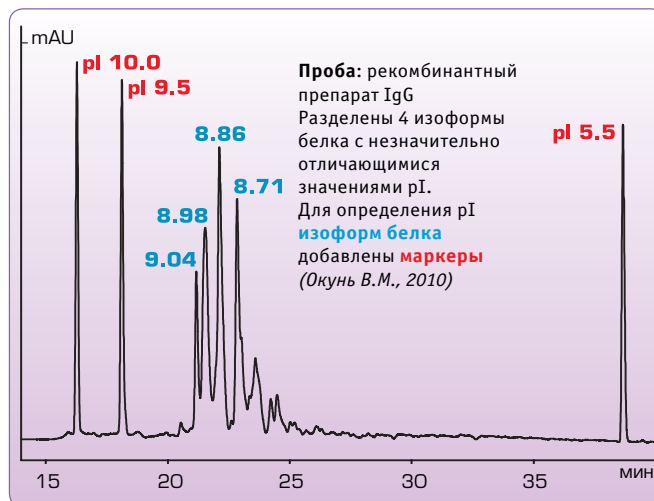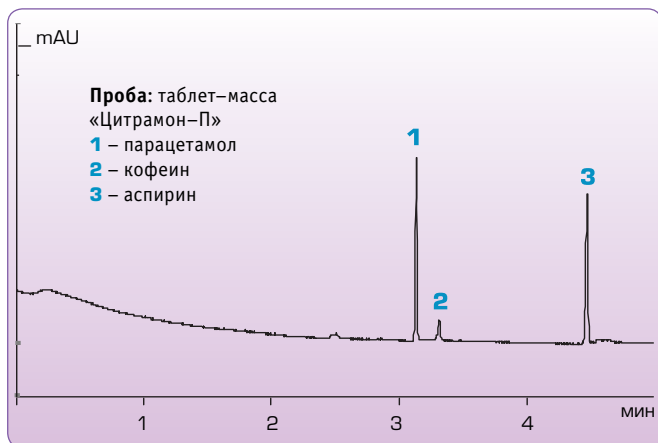

Подробную информацию о возможностях метода КЭ можно найти в специализированном буклете «ЛЮМЭКС» «Система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®». Решение для фарминдустрии».

## СЕРВИС

- Проведение пусконаладочных работ в лаборатории пользователей.
- Бесплатное сервисное обслуживание (условия на сайте) – 36 месяцев.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- Информационная поддержка и сопровождение.
- Обеспечение расходными материалами для большинства методик.
- Адаптация методик к условиям Заказчика.
- Разработка и аттестация методик по специальному заказу.
- Бесплатный первичный инструктаж в лаборатории ГК «ЛЮМЭКС» приемам и методам работы на выпускаемых фирмой приборах.
- Проведение семинаров пользователей.
- Ежедневные консультации по вопросам эксплуатации приборов, по работе с методическим и программным обеспечением от ГК «ЛЮМЭКС».
- Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях.
- Предповерочная подготовка приборов.
- Развитый сервис на всей территории России и СНГ, региональные сервис-инженеры в 25 регионах России.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

Метрологическая служба фирмы аккредитована на проведение работ по аттестации методик (методов) измерений и метрологическую экспертизу документов согласно области аккредитации.

Все приборы «ЛЮМЭКС» внесены в Госреестр средств измерений России, а также ряда стран СНГ.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробную информацию о возможностях приборов «ЛЮМЭКС», методах анализа и методических решениях можно найти на сайте [www.lumex.ru](http://www.lumex.ru).

**Если Вы не нашли в нашем буклете готового решения  
Вашей аналитической задачи, пожалуйста, свяжитесь со  
специалистами «ЛЮМЭКС» по телефону, факсу или по электронной  
почте, и мы обсудим наиболее эффективные пути ее решения.  
Гарантией этому служит наш успешный двадцатилетний опыт работы  
на рынке российской аналитики.**

Вся информация в настоящей публикации является справочной.

### Центральный офис «ЛЮМЭКС»: ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 70, корп. 2  
Тел.: +7 (812) 718-5390, 718-5391  
факс: +7 (812) 718-68 - 65  
Эл. почта: lumex@lumex.ru

**Почтовый адрес:** 190000 Санкт-Петербург, BOX 1234  
[www.lumex.ru](http://www.lumex.ru)

### Московское отделение «ЛЮМЭКС»: ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ»

117246, Москва, Научный проезд, 20,  
строение 3, 6 этаж  
Тел.: (495) 981-54-49  
Эл. почта: byl@lumex.ru



13BPOO.03-1

\* 1 год гарантии и 2 года дополнительного бесплатного технического обслуживания; предоставляется только на оборудование собственного производства, введенное в эксплуатацию Группой компаний «ЛЮМЭКС» при условии проведения пуско-наладочных работ. Действует только на территории Российской Федерации.